家庭用 エアマッサージ器

ドクターメドマー®

医療機器認証番号 225AHBZX00015000

型式 **DM-6000** PAT D.PAT

類　　別：機械器具77 バイブレーター
（JMDNコード：34663000）
一般的名称：家庭用エアマッサージ器
クラス分類：Ⅱ（管理医療機器）
特定保守：非該当

両脚セット

158,000円
＋消費税

ショートブーツセット

128,000円
＋消費税

片腕セット

113,000円
＋消費税

■主な仕様

電源		AC100V　50／60Hz
消費電力（待機中）		34／29W（3／3W）
もみ上げサイクル	ウェーブモード	約50秒
	スクイーズモード	約35秒
	ハイパーモード	約24秒
タイマー設定時間		10分、20分、30分
空気圧設定範囲		4.0 ～ 17.3kPa（30～130mmHg）
定格時間		30分
質量		本体：4.8kg ブーツ2本：0.85kg　ホース：0.95kg

●オプション（別売品）

ホース

- ●両脚用 H-52A　10,000円＋消費税
- ●片脚用 H-50A　6,000円＋消費税
- ●ショートブーツ用 H-53A　10,000円＋消費税
- ●アームバンド用 H-51A　7,000円＋消費税

電源コード

- ●電源コード CAB-100　3,000円＋消費税

ファスナー交換ベルト（消耗品）



- ●ブーツ用 Z-6000　3,700円＋消費税
- ●ショートブーツ用 ZSB-6000　3,500円＋消費税

Lサイズベルト（消耗品）

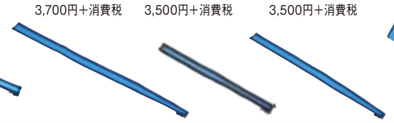

- ●ブーツ用 Y-50A　3,700円＋消費税
- ●ショートブーツ用 Y-52A　3,500円＋消費税
- ●アームバンド用 Y-51A　3,500円＋消費税

ブーツ（消耗品）



- ●脚用 B-6000　35,000円＋消費税

ショートブーツ（消耗品）



- ●脚用 SB-6000　20,000円＋消費税

アームバンド（消耗品）



- ●腕用 U-6000　27,000円＋消費税

⚠ 使用上の注意　「ドクターメドマー」を使用する場合、以下の点に注意してください。

⚠ 警告

●次の人は、本機の使用を禁止します。

1. 医師からマッサージを禁じられている人
（例：血栓（塞栓）症、重度の動脈りゅう（瘤）、急性静脈りゅう（瘤）、各種皮膚炎および皮膚感染症［皮下組織の炎症を含む］など）
2. 発症後6ヶ月以内の下肢深部静脈血栓症を患っているか、もしくはその恐れのある場合。
※「下肢深部静脈血栓症」とは、下肢全体または膝より下が腫れ上がって痛みがあり、立ったり歩いたりすると痛みが強くなる自覚症状のあることをいいます。
3. 装着部におでき、やけど、虫さされなどの急性炎症や化膿性疾患がある場合。

●本機の改造、分解、修理は絶対にしないでください。事故の原因になります。

⚠ 注意

●次の人は必ず医師と相談のうえ使用してください。症状や病因によっては使用に適さない場合があります。

1. ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用してる人
2. 心臓に障害がある人
3. 高血圧症と診断されている人
4. 悪性しゅよう（腫瘍）のある人
5. 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
6. 体温38℃以上（有熱期）の人
7. 骨粗しょう（鬆）症の人、せきつい（脊椎）の骨折、急性［とう（疼）痛性］疾患の人
8. 妊娠初期の不安定期または、出産直後の人
9. 安静を必要とする人
10. 特に身体に異常を感じている人
11. 皮膚の弱い人
12. 施療部位に疾患から生じるむくみや疼痛のある人
13. 施療部位に骨折、脱きゅう、肉ばなれ、ねんざ、皮膚に創傷のある人
14. 上記以外の疾患で医師の治療を受けている人
15. 自覚症状の意思表示ができない人
16. 本機の使用によりかえって疼痛の増す人
17. 本機を使用しても症状の改善が見られない人
18. 腱鞘炎の人（アームバンド使用時に限る）

●通常、圧力設定は「3」以下でご使用ください。特にお肌の弱い方は、圧迫痕が残ることがあります。

◆ご使用前に必ず取扱説明書をお読みになり、安全にご使用ください。 ◆本カタログに記載の仕様および内容は2013年10月現在のものです。予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ご用命は：

販売元
メドー産業株式会社
本　　社 〒146-0081 東京都大田区仲池上2-9-4
TEL 03（5748）5521（代表）　FAX 03（3754）0258
大阪支店 〒537-0001 大阪市東成区深江北 2-10-10
TEL 06（6976）3271（代表）　FAX 06（6976）3841

製造販売元
日東工器株式会社

ISO 14001 認証
JQA-EM4057
日東工器（株）およびメドー産業（株）は、ISO 14001（環境マネジメントシステム）に関する国際規格の認証を取得しています。

ISO 9001 認証
JQA-2160
日東工器（株）リニア事業部は、ISO 9001（品質マネジメントシステム）に関する国際規格の認証を取得しています。

製品に関する様々な情報をご案内しております。
www.medo.co.jp/
eメールアドレス ： sales@medo.co.jp

《お客様ご相談窓口》メドー産業株式会社
フリーダイヤル **0120-265521**
受付時間：AM9:00～PM5:00（土・日・祝日を除く）

●このカタログは風力発電による自然エネルギーを使用して、植物油インキで印刷しています。

※本カタログの無断複写を固くお断わりします。

12JNet20-①

MEDO Automatic Air Massager

カタログNo.L415

医療機器認証番号
225AHBZX00015000

家庭用 エアマッサージ器

ドクターメドマー®

型式 **DM-6000** PAT D.PAT

●両脚セット　●ショートブーツセット　●片腕セット

エアマッサージで、健康な身体づくり

お好みで選べる4種類のマッサージモード

- ● ウェーブモード（もみ上げ）
- ● ハイパーモード（同時加圧）
- ● スクイーズモード（絞り上げ）
- ● コースモード（組み合せ）

電源コードをACインレット化、
ファスナー交換ベルトの採用で
メンテナンス性が大幅UP

NITTO
NITTO KOHKI CO.,LTD.

Dr. MEDOMER®

ビジネス・スポーツ・家事・外出の後の筋肉の疲れを効果的にやわらげます

家庭用 エアマッサージ器
ドクターメドマー®

ソフトな空気の力で血行促進マッサージ！
今日から身体、軽やか爽快！！

Automatic Air Massager
Dr. MEDOMER® DM-6000
PAT D.PAT

「血液とリンパ液の効果的な流れの促進」をテーマに、使いやすさと理想的な効果の追求から誕生した「ドクターメドマー」。
機能性・操作性・耐久性に優れ、しかもコンパクト設計。 ゆったりとくつろいだ姿勢で手軽にご利用ください。
※体を温めリラックスした状態でご利用いただくと最も効果が得られます。

効能・効果

- 血行促進
- 疲労回復
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のコリをほぐす
- 神経痛、筋肉痛の痛みの緩解

特長

- 圧力センサによる制御で、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが行えます。
- 空気袋をオーバーラップさせてあり、もみ残し部位のない効果的なマッサージが行えます。
- すべての操作がスイッチボタンで簡単に行え、手軽にご利用いただけます。
- ソフトな空気圧によるマッサージで、局部的な痛みや電気的な刺激がなく快適です。
- 電源コードをACインレット化して劣化・損傷時の交換を容易にしました。
- ファスナー交換ベルトの採用でファスナー交換を容易にしました。

血行（血流）を阻害しない、最適な加圧 ▶

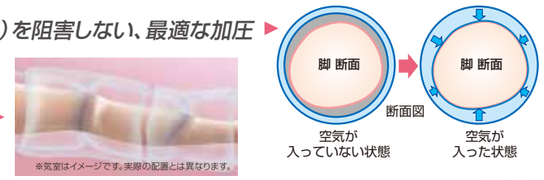

もみ残し部位のないオーバーラップ機能 ▶

使いやすい操作パネル

※電源投入時

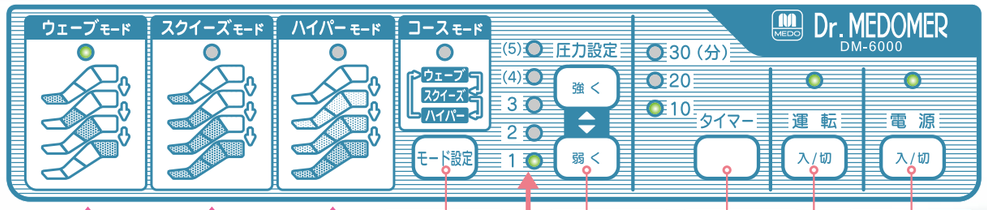

4種類のマッサージパターンが選べます。
「モード設定ボタン」を押すだけで、簡単に4種類のモードを切り換えでき、LEDランプの点灯で選択モードを確認できます。

モード設定ボタン
4種類のマッサージモードがお選びいただけます
設定されたモードには緑色の表示ランプが点灯します。

圧力設定ボタン
5段階の強弱がお選びいただけます
安全のため、圧力「4」「5」はボタンを1秒以上押さなければ作動しません。

タイマーボタン
3種類の時間設定をお選びいただけます

電源入/切ボタン
本機を使用する際、最初に押してください

運転入/切ボタン
マッサージを始める際に押してください

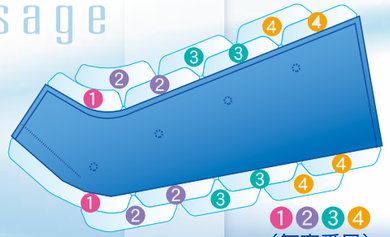

圧力表示ランプ	気室圧力 kPa (mmHg)				
	ウェーブモード および スクイーズモード				ハイパーモード
	1	2	3	4	全気室
(5)	17.3(130)	16.0(120)	14.7(110)	12.0(90)	17.3(130)
(4)	14.7(110)	13.3(100)	12.0(90)	10.7(80)	14.7(110)
3	12.0(90)	10.7(80)	9.3(70)	9.3(70)	12.0(90)
2	9.3(70)	8.0(60)	6.7(50)	5.3(40)	9.3(70)
1	4.0(30)	4.0(30)	4.0(30)	4.0(30)	4.0(30)

注）上記圧力は1.3kPa程度のバラツキがあります。

圧力設定ボタンを押すだけで、簡単に圧力調節ができます。

脚は第二の心臓。歩く度に血液を心臓へ送るポンプです。

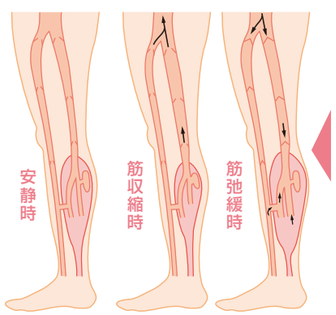

ふくらはぎの筋肉は足先から心臓へと血液を送る役割もしています。

歩く運動は「ふくらはぎ」の筋肉運動で、下半身にたまった静脈血液を心臓に押し上げる作用を促進し、脚の血行を高めます。そして、からだ全体の血行を活発にします。

血流促進が大切な理由

血液は心臓というポンプによってからだの中を循環しています。心臓を中心として送りだされる「血液を運ぶ血管」を**動脈**、反対に心臓にもどる「血液が通る血管」を**静脈**といいます。血液の場合、渋滞が起こり易いのは静脈で、特に太ももから下の脚部は、心臓から遠く、下の方にあるため、一番渋滞が起こりやすい部分なのです。

マッサージは、血液の慢性的渋滞部分ともいうべき下肢静脈血の心臓への還流促進にすぐれた効果を発揮します。

普通の状態

静脈に空気圧を加えて圧縮し、血液の循環を促進させます。



メドマー使用時

進化したマッサージ機能

4種類のマッサージモード

加圧
排気
血流

加圧のしくみ

ウェーブモード（もみ上げ）

つま先から太ももへ向かって順番に加圧・排気しながらもみ上げます。（1～6の動作を繰り返します）

スクイーズモード（絞り上げ）

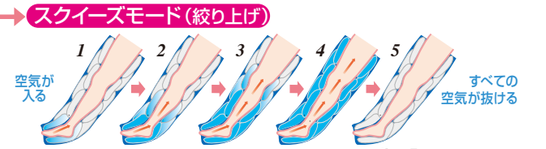

つま先から太ももへ向かって順番に加圧したまま絞り上げます。（1～5の動作を繰り返します）

ハイパーモード（同時加圧）

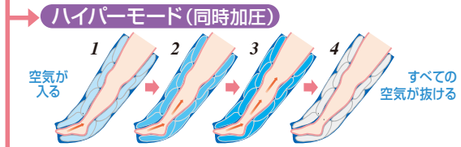

すべての気室を同時に加圧します。（1～4の動作を繰り返します）

コースモード（3モードの組み合せ）

ウェーブモード 2回 ▶ スクイーズモード 2回 ▶ ハイパーモード 1回

「ウェーブ2回→スクイーズ2回→ハイパー1回の動作を繰り返します。

5段階の圧力設定でお好みの強弱をお選びいただけます。

安全のため、圧力「4」「5」は1秒以上ボタンを押し続けなければ設定できないようになっています。

⚠ 注意
通常、圧力設定は「3」以下でご使用ください。特にお肌の弱い方は、圧迫痕が残ることがあります。安全のため、圧力「4」「5」は1秒以上ボタンを押し続けなければ設定できないようになっています。